

Szczecin 20-02-2012r

znak sprawy: ZP/220/06/12w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 130 000 Euro)
na dostawę bielizny ochronnej i operacyjnej**Wyjaśnienia nr 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Zadanie nr 5:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 150x100 cm?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 2**

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę przyklejaną?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 3**

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści serwetę o grubości folii 33 mikrony?

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza. Proponowana serweta ma za małą grubość.****Pytanie 4**

Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łata chłonna i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

1 kieszeń dwukomorowa 30x40 cm

Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 5**

Zadanie nr 8:

Poz.1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o następujących parametrach i składzie:

1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona

4 ręczniki do rąk

1 taśma op 9 x 50 cm

1 prześcieradło dla dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 330x230 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36 cm, uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m²

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.

Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485

Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Zadanie nr 8

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny o następujących parametrach i składzie:

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145

4 ręczniki do rąk

2 taśmy op 9 x 50 cm

1 przyklejana serweta 75 x 90 cm z łata chłonna 15x50 cm

1 serweta 75 x 80 cm

1 serweta z wcięciem 150 x 250 cm, łata chłonna 50x50 cm, wcięcie 7 x 70 cm, uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

1 serweta przylepna 180x180 cm pakowana osobno (1 szt./opakowanie) i wliczona w cenę pozycji

1 kieszeń dwukomorowa 30x40 cm pakowana osobno (1 szt./opakowanie) i wliczona w cenę pozycji

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.

Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485

Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x80 cm z otworem 6x15 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o następującym składzie:

1 warstwa ochronna 10 x 12 cm

1 serweta okulistyczna 150 x 180 cm, torebka na płyny, zintegrowana warstwa ochronna z owalną przesłoną 5 x 7 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm

Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Zadanie nr 14:

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Zadanie nr 16:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o grubości folii 40 mikronów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Zadanie nr 16:

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o grubości folii 40 mikronów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Zadanie 16

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kieszeń o grubości folii 40 mikronów i wymiarach 30x40 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie 16

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kieszeń o grubości folii 40 mikronów i wymiarach 30x40 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Zadanie 16

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści kieszeń o grubości folii 40 mikronów i wymiarach 62x50 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Zadanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o następującym składzie:

1 warstwa ochronna 10 x 12 cm

1 serweta okulistyczna 150 x 180 cm, torebka na płyny, zintegrowana warstwa ochronna z owalną przesłoną 5 x 7 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Zadanie nr 18:

Poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch pięciowarstwowy z tkaniny SSMMS ze ściereczkami o wymiarach min. 27x27 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Zadanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku bez możliwości sterylizacji?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 18

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 2

Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych wykonanych z włókniny czterowarstwowej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

ZADANIE NR 2

Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepeków chirurgicznych wykonanych z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 14g/m². Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

ZADANIE NR 2

Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepeków chirurgicznych wykonanych z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 25g/m². Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21

ZADANIE NR 2

Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepeków chirurgicznych posiadających taśmę pochłaniającą pot na całym obwodzie głowy? Pozostałe parametry czepeków bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22

ZADANIE NR 4

Poz. nr 4 i 5 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wydzielenie powyższych pozycji z pakietu nr 4, i utworzenie z nich oddzielnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych wyżej pozycji.

Pytanie 23

ZADANIE NR 4 Poz. nr 4 i 5

Jednocześnie prosimy |Zamawiającego o możliwość zaoferowania w tych pozycjach podkładów wykonanych z bibuły ze spodnią warstwą z folii. Podkłady te szybko wchłaniają wodę i chronią przed wilgocią. Pozostałe parametry podkładów bez zmian.

Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw podkładów nieprzemakalnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych podkładów

Pytanie 24

ZADANIE NR 5

Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na stolik Mayo, w której część wzmocniona ma wymiar 60cm x 145cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób.

Pytanie 25

ZADANIE NR 6

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie?

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta samoprzylepna 200 x 170 cm
- 1 serweta samoprzylepna 175 x 170 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
- 1 kieszeń samoprzylepna (2sekcje) 43 x 38 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 serwety samoprzylepne Protect 90 x 75 cm

i gramaturze 54 g/m² spełniającego pozostałe parametry opisu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.

Pytanie 26

ZADANIE NR 8

2. **Poz. nr 2 i 3** - zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 i 3 z Zadania nr 8 , co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

w pozycji 1 zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

i gramaturze 54 g/m² spełniającego pozostałe parametry opisu.

w pozycji 2 zestawu do operacji laryngologicznych:

Uniwersalny zestaw z serwetą z wycięciem U i wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”	150 x 240
1 serweta samoprzylepna	200 x 240
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	33 x 33



z dodatkowo osobno pakowaną kieszenią, i gramaturze 55 g/m², w części podstawowej , a w obszarze wzmocnień 110 g/m² spełniającego pozostałe parametry opisu. Obydwa zestawy posiadają wzmocnienia w części krytycznej i spełniają wymogi normy EN 13795.

Odpowiedź

Zamawiający nie wydziela z zadania nr 8 wskazanych pozycji oraz nie dopuszcza proponowanego zestawu.

Pytanie 27

ZADANIE NR 10

3. **Poz. nr 1** – Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania Serwety w rozmiarze 120cm x 150cm posiadającej otwór Ø7cm, pozostałe parametry bez zmian.

Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 28


ZADANIE NR 15

4. zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z Zadania nr 15, co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

w pozycji 3 zestawu do operacji kończyn dolnych o następującym składzie:

Zestaw do operacji żyłaków wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy	140 x 190
1 serweta samoprzylepna wzmocniona z wycięciem „U”	260 x 200
1 serweta samoprzylepna wzmocniona (głowa)	170 x 250
1 serweta nieprzylepna	150 x 100
1 osłona na krocze	35 x 20
2 ręczniki celulozowe	33 x 33

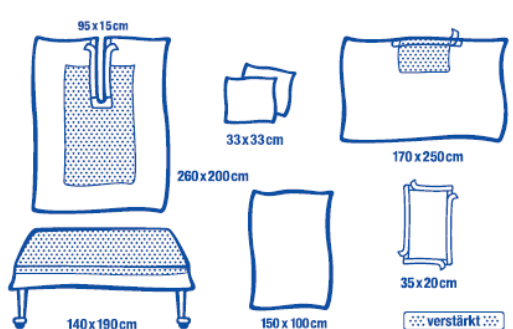

z dodatkowo osobno pakowaną taśmą lepną i gramaturze 55 g/m² w części podstawowej , a w obszarze wzmocnień 110 g/m² spełniającego pozostałe parametry opisu.


Odpowiedź

Zamawiający nie wydziela i nie dopuszcza proponowanego zestawu.

Pytanie 29

ZADANIE NR 17

5. **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety okulistycznej o następujących wymiarach:

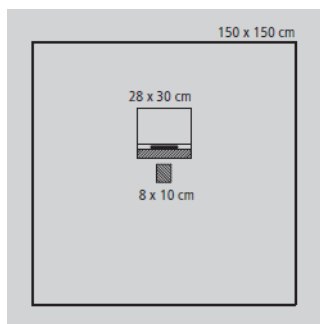

Foliodrape® Zestaw okulistyczny

Serweta okulistyczna z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8 x 10 cm) i kieszenią na płyny (28 x 30 cm)

150 x 150

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30

ZADANIE NR 18

Poz. nr 1 i 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych zawiniętych w papier krepowy zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Zadanie nr 18

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczki celulozowej o rozmiarze 33cm x 33cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

ZADANIE NR 19

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego, w którym bluza posiada min. jedną kieszeń w rozmiarze min. 16 x 18 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 33

zadanie 2, pozycja 1, 3

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z trokami o długości 38cm +/-5cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby maski chirurgiczne były w kartonie w formie podajnika?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby maski były w kartonie w formie podajnika

Pytanie 35

zadanie 2, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści czepek męski pakowany a'100sztuk w zbiorczym woreczku, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 36

zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści niejałową chustę trójkątną w rozmiarze 136x96x96, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 37

zadanie 4, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 38

zadanie 4, pozycja 4-5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji.

Pytanie 39

zadanie 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jałowy podkład o wymiarach 160x220cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 40

zadanie 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sterylne osłonę na stół Mayo o gramaturze 56g/m², spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41

zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna, dolna z łąką chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu.

Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką

chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 42

zadanie 7, zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 75 x 90cm

Serweta 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 75 x 90cm

Serweta 2 - warstwowa, samoprzylepna z otworem o wym. 6 x 8 cm, otwór przylepny.

Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70x120cm

wykonana z włókniny z podwójnie wywinętym brzegiem

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia

w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43

zadanie 7, zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90 x 120cm

2 warstwowa, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70x120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wywinętym brzegiem

1x Serweta urologiczno - ginekologiczna o wym.75 x 200cm

2 warstwowa z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie półkoła o promieniu 15cm Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

4 x Ręcznik do rąk 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44

zadanie 7, zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm

Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzuszynym o śred. 3 cm i kroczywym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwi dopasowanie drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45

zadanie 8, zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwi dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 46

zadanie 8, zadanie 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Pytanie, pakiet 8, zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwowa o wym. 75 x 80 cm z otworem przyklepnym o wym. 6 x 15cm i 4rema przylepcami w rogach serwety, gramatura serwety 75 g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji oraz nie dopuszcza proponowanych serwet.

Pytanie 47

zadanie 9, zadanie 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji

Pytanie 48

zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną w rozmiarze 120x170cm z folią operacyjną i 2 kieszeniami na płyny. Serweta wykonana z włókna, okienko z folią operacyjną o wym. 10x10cm. Posiada 2ie kieszenie na płyny o wym. 20x25 cm, z usztywnieniem/kształtką metalową w górnej części kieszeni. 1 usztywnienie/ kształtka metalowa o dług. 40cm, do ufixowania całej serwety?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów

Pytanie 49

zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościelowy wykonany w włókna polipropylenowej o składzie:

prześcieradło 210x150, poszewka na kołdrę 210x160, poszewka na poduszkę 70x80?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 50

zadanie 13, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce perforowany co 38cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 51

zadanie 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o długości 80mb, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 52

zadanie 15, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 53

zadanie 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 180cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm

Serweta z otworem samouszczelniającym się, otwór śr.3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym.170 x 180cm

Serweta wykonana z włókniny, samoprzylepna.

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 54

zadanie 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica, 70 x 120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia

w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 55

zadanie 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy na przewody wykonany z folii PR o gramaturze 40g/m², spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 56

zadanie 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy na elementy aparatury wykonany z folii PR o gramaturze 40g/m², spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 57

zadanie 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną jednokomorową wykonaną z folii PR o gramaturze 40g/m², spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 58

zadanie 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową wykonaną z folii PR o gramaturze 40g/m², spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 59

zadanie 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną trójkątną wykonaną z folii PR o gramaturze 40g/m², spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 60

zadanie 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną jednokomorową o wymiarach 30x40cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

zadanie 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wymiarach 30x40cm, każda część?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 62

zadanie 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną trójkątną w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną w rozmiarze 120x170cm z folią operacyjną i 2 kieszeniami na płyny. Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią operacyjną o wym. 10x10cm. Posiada 2ie kieszenie na płyny o wym. 20x25 cm, z usztywnieniem/kształtką metalową w górnej części kieszeni. 1 usztywnienie/ kształtka metalowa o dług. 40cm, do ufixsowania całej serwety?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 64

zadanie 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

zadanie 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby szwy były wykonane metoda ultradźwiękową?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza innej metody wykonania szwów.

Pytanie 66

zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z bluza bez kieszeni, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 67

zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

zadanie 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik 100 x 150 cm

Serweta 2 warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 100 x 150 cm

Serweta wykonana z włókniny

1 x Serweta do angiografii udowej o wym. 220 x 320cm

Serweta z 2ma okrągłymi otworami o wym 6 x 8cm, przylepnymi. Serweta z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym i przezroczystą folia polietylenową na obrzeżach serwety. Serweta w polu niekrytycznym wykonana z włókniny. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Fartuch chirurgiczny Standard rozmiar XL

1 x Taśma przylepna o wym. 10x25cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 69

projekt umowy, zakres 11

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §11:

1. b/ w przypadku odstąpienie przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości **10% niezrealizowanej wartości brutto umowy?**

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 70

Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny zabiegowy zgodny z SIWZ z rękawami wykończonymi elastycznymi ściągaczami poliestrowymi, co nie powoduje pylenia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71

Zadanie nr 2, poz. 1-2

W celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. 1 i 2 do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyłącza wskazanych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 72

Zadanie nr 3, poz. 2

Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga w tej pozycji serwety w rozmiarze 75cm x 90cm?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wystąpienie oczywistej omyłki. Zamawiający wyjaśnia iż ofertę należy złożyć na przedmiot Zamówienia opisany w formularzu cen jednostkowych z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień

Pytanie 73

Zadanie nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną o rozmiarze 100x100x140cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 74

Zadanie nr 4, poz. 1-3

W celu zwiększeni konkurencyjności składanych ofert zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 1, 2 oraz 3 do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyłącza wskazanych pozycji z zadania 4.

Pytanie 75

Zadanie nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 200x180cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76

Zadanie nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 240x180cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Zadanie nr 5, poz. 4

Czy zamawiający dopuści sterylną osłonę na stół Mayo o warstwie chłonnej 76x85cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78**Zadanie nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie jak poniżej

serweta z przylepcem laminatu dwuwarstwowego	1 szt.	240x150cm
serweta z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego	1 szt.	180x170cm
serweta z laminatu dwuwarstwowego z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2 szt.	90x75cm
taśma medyczna	1	50x9cm
serweta na stół instrum.	1	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1	145x80cm
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20cm

z dodatkowo wycenioną osobno zapakowaną dwukomorową kieszenią w rozmiarze 30x25cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 79**1. Zadanie nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ściereczki do wysuszania rąk w rozmiarze 50x40cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80**Zadanie nr 9, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ściereczki higieniczne niesterylne wykonane z włókniny kompresowej, o gramaturze 40 g, w rozmiarze 80x60cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 81**Zadanie nr 9, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 225x160mm wykonaną z celulozy i folii o gramaturze 5g?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 82**Zadanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościelowy o następującym składzie:

Powłoka	200 x 150cm
Powłoczka	90 x 75cm
prześcieradło	210 x 150cm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83**Zadanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 25m?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w zadaniu 12 podkład w rolce o długości 25m pod warunkiem przeliczenia ilości zaoferowanych sztuk rolek tj. zaoferowania 260 sztuk rolek (zamiast 130 szt. po 50mb).

Pytanie 84

Zadanie nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50x60cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85

Dotyczące wzoru umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 86

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 87

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów” zostały zastąpione słowami „wartości brutto niedostarczonych w terminie lub zareklamowanych wyrobów”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 88

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „10% wartości brutto umowy określonej w § 7 umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 89

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 ust. 2 wzoru umowy został dopisany podpunkt lit. d) o następującej treści: „zmiany ceny w razie przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w razie gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dopisanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 90

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach zadania nr 1 co zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach zadania 1.

Pytanie 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego zadania pozycji 4-6 z zadania nr 2, jako jednorodnej grupy asortymentowej, co zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji.

Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 2 poz.6 czepka z pojedynczą wstawką pochłaniającą pot lub czepka zgodnego z opisem z poz.5 w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 93

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 2 poz.5 czepka w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 94

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 4 poz.4 i 5 prześcieradła nieprzemaklanego w kolorze białym, wzmocnionego, wykonanego z chłonnego i wytrzymałego laminatu celulozowo-foliowego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 95

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 11 poz.1 zestawu pościeli o następującym składzie:

- poszewka 70x80cm - 1szt,
- poszwa 160x200cm - 1szt,
- prześcieradło 160x210cm - 1szt?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 96

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr19 poz.1 ubrania z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97

Zadanie 10. czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 113 x 150 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowaną serwetę z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w siwz

Pytanie 98

Zadanie nr 1 poz.1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów w opakowaniach pośrednich 50szt.

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 99

Zadanie nr 1 poz.2

Prosimy o dopuszczenie fartuchów sterylnych w opakowaniach pośrednich 25szt.

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100

Zadanie nr 6: Zestaw serwet uniwersalny do zabiegów długich sterylny

1.Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy o grubości 40 µm z folii PE w rozmiarze 156x200 cm (opakowanie wewnętrzne)
- 2 x ręcznik do rąk 15x20 cm
- 1 x taśma klejąca włókninowa 9 x 50 cm
- 1 x pokrowiec na stolik Mayo 77x142 cm o grubości 50µ z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna przylepna 75x90 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m²
- 1 x serweta dolna przylepna 175x175 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m² z panelem z niebieskiej folii PE 25x175 cm
- 1 x serweta górna przylepna 160x260 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m² z panelem z niebieskiej folii PE 10x260 cm

Opakowanie zbiorcze 10 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Lub

2.Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy o grubości 40 µm z folii PE w rozmiarze 156x200 cm (opakowanie wewnętrzne)
- 2 x ręcznik do rąk 15x20 cm
- 1 x taśma klejąca włókninowa 9 x 50 cm
- 1 x pokrowiec na stolik Mayo 77x142 cm o grubości 50µ z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna przylepna 75x90 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m²
- 1 x serweta dolna przylepna 175x175 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m² z panelem z niebieskiej folii PE 25x175 cm
- 1 x serweta górna przylepna 160x260 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m² z panelem z niebieskiej folii PE 10x260 cm

Oraz osobno:

- 1x torba na narzędzia z dwiema kieszeniami PE w rozmiarze 35x35cm, pakowana w papier, opakowanie sterylne.

Całość zapakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta i symbolami elementów zestawu.

Opakowanie zbiorcze 10 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyrobu proponowanego w pkt 1. Zamawiający dopuszcza wyrób opisany w pkt 2 powyższego pytania.

Pytanie 101

Zadanie nr 6: Zestaw serwet uniwersalny do zabiegów długich sterylne

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w składzie:

- 1xserweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem w rozmiarze 152x193cm z folii PE
- 1xserweta na stolik Mayo ze wzmocnieniem w rozmiarze 75x141cm z folii PE
- 2xserwety boczne w rozmiarze 75x93cm ze wzmocnieniem chłonnym 37x58cm wykonane z trójwarstwowego laminatu typu SMS o gramaturze 43g/m²
- 1xserweta dolna w rozmiarze 175x183cm wykonana z trójwarstwowego laminatu typu SMS o gramaturze 43g/m² ze wzmocnieniem chłonnym 37x65cm ze zintegrowaną taśmą typu rzep
- 1xserweta górna w rozmiarze 152x250cm wykonana z trójwarstwowego laminatu typu SMS o gramaturze 43g/m² ze wzmocnieniem chłonnym 37x65cm ze zintegrowaną taśmą typu rzep
- 4xręczniki chłonne 34x36cm

Opakowanie zbiorcze 5 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Lub

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w składzie:

- 1xserweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem w rozmiarze 152x193cm z folii PE
- 1xserweta na stolik Mayo ze wzmocnieniem w rozmiarze 75x141cm z folii PE
- 2xserwety boczne w rozmiarze 75x93cm ze wzmocnieniem chłonnym 37x58cm wykonane z trójwarstwowego laminatu typu SMS o gramaturze 43g/m²
- 1xserweta dolna w rozmiarze 175x183cm wykonana z trójwarstwowego laminatu typu SMS o gramaturze 43g/m² ze wzmocnieniem chłonnym 37x65cm ze zintegrowaną taśmą typu rzep
- 1xserweta górna w rozmiarze 152x250cm wykonana z trójwarstwowego laminatu typu SMS o gramaturze 43g/m² ze wzmocnieniem chłonnym 37x65cm ze zintegrowaną taśmą typu rzep
- 4xręczniki chłonne 34x36cm

Oraz osobno:

- 1x torba na narzędzia z dwiema kieszeniami PE w rozmiarze 35x35cm, pakowana w papier, opakowanie sterylne.

Całość zapakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta i symbolami elementów zestawu.

Opakowanie zbiorcze 5 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 102

Zadanie nr 8: Zestawy obłożeń sterylne

Poz.1

Uprzejmie prosimy o wyłącznie poz.1 z Zadania nr 8 i utworzenie nowego zadania, np. 8A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 103

Zadanie nr 8: Zestawy obłożeń sterylne

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie zestawu owiniętego w sterylny papier krepowy 86x86cm zawierającego:

-1xserweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE o grubości 50µm (opakowanie wewnętrzne)

-1 x kocyk dla noworodka bawełnopodobny 100x105 cm

- 1 x serweta główna wykonana z trójwarstwowego materiału polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 62g/m² w rozmiarze 196x249x300 cm z osłoną ramion stołu, otwór 30x36 cm z folią operacyjną, 2 x wzmocnienie chłonne, 4 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny, 2 porty do ssaka

- 1 x serweta na stolik narzędziowy z folii PE o grubości 50µm 120x140 cm

- 2 x ręcznik chłonny 15x20 cm, wzmocniony siecią syntetyczną

- 1 x taśma klejąca foliowa 8x40 cm

Oraz osobno:

- 1 x pokrowiec na stolik Mayo z folii PE 77x142 cm o grubości 50µm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm

Całość zapakowana w torbę/worek zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta i symbolami elementów zestawu.

Opakowanie zbiorcze 6 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 104

Zadanie nr 8: Zestawy obłożeń sterylne

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1xserweta na stolik narzędziowy z folii PE w rozmiarze 152x193cm ze wzmocnieniem chłonnym

1xserweta na stolik Mayo z folii PE e rozmiarze 75x141cm ze wzmocnieniem chłonnym

1xSerweta do cięcia cesarskiego w rozmiarze 198/259x307cm wykonana z włókniny celulozowo-poliestrowej typu Spunlace o gramaturze 76g/m² z oknem 33x38cm, brzegi wypełnione folią operacyjną, otwór centralny bez folii, gruszkowaty 18x18cm, torba 360°, 3 mocowania do przewodów typu rzep

4xRęcznik do rąk

Opakowanie zbiorcze 6 zestawów z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych zestawów.

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 105

Zadanie nr 10: Serwety do zabiegów okulistycznych

Poz.1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie sterylnej serwety okulistycznej o wymiarach 122x158cm wykonanej z laminatu nieprzemakalnego pięciowarstwowego typu SMMMS o gramaturze 35g/m², posiadającej otwór o wymiarach 4,5x7cm przylepny w opakowaniu zbiorczym 60serwet, z odpowiednim przeliczeniem ilości zestawów, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106

Zad. Nr 14: Serwety jałowe

Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie opakowania zbiorczego serwet 120 szt. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 107

Zad. Nr 14: Serwety jałowe

Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie opakowania zbiorczego serwet 120 szt. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 108

Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru serwet 50x50 cm oraz opakowania zbiorczego serwet 350 szt. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 109

Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru serwet 75x75 cm oraz opakowania zbiorczego serwet 180 szt. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 110

Zad nr 17: Serwety do zabiegów okulistycznych sterylne

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie serwety wykonanej z 5 warstwowego materiału SMMMS o gramaturze 35g/m², o wymiarze 122x158 cm z otworem w pełni wypełnionym folią operacyjną w rozmiarze 8,5x11cm, ze zintegrowanymi dwustronnymi kieszeniami na płyny w rozmiarze ok.16x30cm każda oraz elastycznym paskiem. Opakowanie zbiorcze 34 zestawy z odpowiednim przeliczeniem zamawianych zestawów. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 111

Zadanie nr 18: Fartuchy i ubrania chirurgiczne

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o wytrzymałości na rozdarcie/rozerwania na sucho 180kPa zamiast 125kPa oraz na mokro 122kPa zamiast 125kPa, szwy fartuchów wykonane metodą podwójnego szycia natomiast rękawy klejone w sposób zapewniający barierowość (brak miejsc przejścia igły przez materiał w trakcie szycia gwarantują wyższą barierowość połączenia).

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 112**Zadania 18 Poz.2 Fartuchy i ubrania chirurgiczne**

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o wytrzymałości na rozdarcie/rozerwania na sucho 180kPa zamiast 125kPa oraz na mokro 122kPa zamiast 125kPa, szwy fartuchów wykonane metodą podwójnego szycia natomiast rękawy klejone w sposób zapewniający barierowość (brak miejsc przejścia igły przez materiał w trakcie szycia gwarantują wyższą barierowość połączenia). W opakowaniu ściereczka celulozowa o wymiarach 34x36cm o gramaturze 42g/m².

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 113**Zadanie nr 19: Ubrania chirurgiczne****Poz.1**

Prosimy o dopuszczenie ubrań wykonanych z oddychającego 5 warstwowego materiału SMMMS o gramaturze 35g/m². Bluza wyposażona w 3 przednie kieszenie o wymiarach ok. 17,5x18cm. Spodnie i bluza pakowane osobno w celu możliwości dopasowania mieszanych rozmiarów. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 114**Dotyczy punktu 1.2.1 SIWZ:**

Czy w związku z tym, że część wyrobów opisanych w siwz stanowią obłożenia operacyjne, serwety, osłony, fartuchy jako wyroby sterylne czy również próbki dołączane do oferty powinny być dostarczone jako wyrób sterylny gotowy do wypróbowania w warunkach sali operacyjnej?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż próbki dołączane do oferty powinny być dostarczone jako wyrób sterylny gotowy do wypróbowania w warunkach sali operacyjnej.

Pytanie 115**Dotyczy punktu 1.3 SIWZ:**

Praktyka przetargowa dowodzi, że niektórzy oferenci wpisują do kart technicznych parametry podane w siwz a nie te, które są wynikiem przeprowadzonych badań na gotowych wyrobach na zgodność z wymogami normy PN EN 13795 1-3 w notyfikowanym laboratorium. Wobec jeśli pojawiają się wątpliwości co do zapisów w kartach technicznych, któregoś z oferentów, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystosowania zapytania do notyfikowanego laboratorium - czy dany oferent rzeczywiście dokonał badań oferowanych wyrobów?

Odpowiedź

Zamawiający będzie dokonywał badania ofert zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie 116**Zadanie nr 1 poz nr 2**

Fartuch niesterylny zabiegowy wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy wykończone elastycznymi poliestrowymi mankietami o gramaturze 28 g/m² – pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117**Zadanie nr 4 poz nr 1**

Podkład o wymiarach 150x100cm – pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118

Zadanie nr 5 poz nr 1

Jałowy podkład o wymiarach 150x100cm – pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 119

Zadanie nr 6 poz 1 :

1.Zamawiający do większości elementów tego zestawu zastosował tolerancje rozmiarów, czy do pozostałych pozycji również np. taśma lepna , kieszeń samoprzylepna oraz ściereczki chłonne Zamawiający stosuje tolerancje rozmiarów czy też będzie obowiązywał sztywny wymiar zapisany w SIWZ?

Odpowiedź


Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 2 cm

2. Prosimy o dopuszczenie taśmy lepnej w rozmiarze 9x 49 cm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

3.Prosimy o możliwość zaproponowania nast. zestawu :

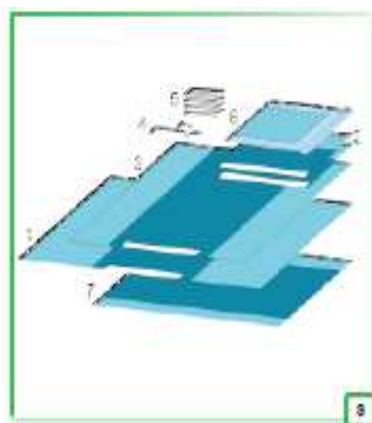


ZESTAW UNIWERSALNY LIGHT I		790500	14	BARRIER	
ZESTAW UNIWERSALNY LIGHT				rozmiar	szt.
1.	senweta górna z taśmą samoprzylepną	240x150	1		
2.	senwety boczne z taśmą samoprzylepną	30x75	2		
3.	senweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1		
4.	taśma samoprzylepna	9x49	1		
5.	ręczniki chłonne	18x25	4		
6.	osłona na stolik MAYO	70x145	1		
7.	senweta na stolik - (owinięcie zestawu)	140x180	1		

Osobno - dwukomorowa kieszeń przylepna z taśmą lepnią o szerokości min. 5,5cm o wymiarach 2x15x40 cm na ssak i koagulację– pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

4. Prosimy o możliwość zaproponowania nast. zestawu :

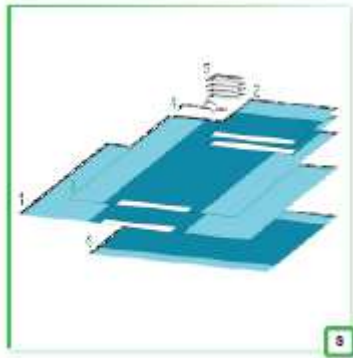

ZESTAW UNIWERSALNY LIGHT II		790000	18	BARRIER
OBŁOŻENIE UNIWERSALNE LIGHT		rozmiar	szt.	
1.	serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anesteziologiczny	210x150	1	
2.	serwety boczne z taśmą samoprzylepną	75x90	2	
3.	serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1	
4.	taśma samoprzylepna	9x49	1	
5.	węczniki chłonne	18x25	4	
6.	serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	180x190	1	

Osobno - dwukomorowa kieszeń przylepna z taśmą lepłą o szerokości min. 5,5cm o wymiarach 2x15x40 cm na ssak i koagulację oraz pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm (+/-10cm) – pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

5. Czy wszystkie serwety wymienione jako elementy tego zestawu (poz nr a,b,c,h) powinny być dwu lub trójwarstwowe na całej powierzchni ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby serwety w podanych pozycjach były dwu lub trójwarstwowe na całej powierzchni

6. Zamawiający wymaga aby oferowany zestaw był przeznaczony do tzw długich zabiegów czy wobec tego należy uznać ,że zamawiający wymaga aby zestaw ten spełniał wymagania wysokie wspomnianej w opisie normy EN 13795 ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby oferowany zestaw spełniał wymagania wysokie normy EN 13795

Pytanie 120

Zadanie nr 8 poz nr 1

Zestaw sterylny składający się z :

a)serweta o wymiarach 180x300cm wykonana z włókniny laminowanej dwuwarstwowej na całejj powierzchni i nieprzemakalnej o gramaturze 63 g/m2, posiadająca w części centralnej otwór we kształcie trapezu o wymiarach 23x33x23cm wypełniony folią chirurgiczną. Worek okalający otwór z usztywnionym brzegiem przechwytyjącym płyny, oraz posiadającym zawór do podłączenia drenu - 1 szt.,

d) taśma samoprzylepna o wymiarach 9x49 cm - 1 szt
pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121

Zadanie nr 8 poz nr 3

Zwracamy się prośba o dopuszczenie gramatury serwety - 45 g/m2 – pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 122

Zadanie nr 9 poz nr 2

Zwracamy się prośba o dopuszczenie rozmiaru ściereczki 30x40 cm – pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 123Zadanie nr 10 poz nr 1

Zwracamy się prośba o dopuszczenie obłożenia o nast. rozmiarach i składzie – pozostałe parametry bez zmian:

**ZESTAW OKULISTYCZNY IV**

380169 20

OBŁOŻENIE OCULUS 130/150

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 130x150 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 9x12 cm otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 37,5x37,5 cm..... | 130x150 | 1 |
| 2. kieszeń samoprzylepna za szywnikiem | 70x20 | 1 |

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 124Zadanie nr 14 poz nr 1

Zwracamy się prośba o dopuszczenie obłożenia o nast. rozmiarach i składzie – pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Pytanie jest nie pełne.

Pytanie 125Zadanie nr 15 poz nr 3,4

Zwracamy się prośba o dopuszczenie rozmiaru ściereczki 18x25 cm występującej jako element (e) w obłożeniu – pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126Zadanie nr 16 poz nr 3,4

Zwracamy się prośba o dopuszczenie rozmiaru kieszeni 40x35 cm – pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127Zadanie nr 16 poz nr 5

Zwracamy się prośba o dopuszczenie rozmiaru kieszeni 60x60 cm – pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128Zadanie nr 18 poz 1

Zwracamy się prośba o dopuszczenie fartucha z dwoma ściereczkami do wytarcia dłoni chirurga oraz zawinięcia w papier krepowy – pozostałe parametry bez zmian.

Czy fartuch powinien spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795 1-3?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż fartuch może spełniać wymagania standardowe jak i wysokie.

Pytanie 129

Zadanie nr 18 poz 2

Zwracamy się prośba o dopuszczenie fartucha wraz dwoma ściereczkami do wytarcia dłoni chirurga w rozmiarze 18 x 25 cm oraz zawinięcia w papier krepowy.

Czy fartuch powinien spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795 1-3?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż wymaga aby fartuch spełniał wymagania wysokie wskazanej normy.

Pytanie 130

Zapytanie dotyczy następujących zadań :

Zadanie nr 5 poz 1-4

Zadanie nr 7 poz 1- 3

Zadanie nr 8 poz 1- 3

Zadanie nr 10 poz 1

Zadanie nr 14 poz 1- 3

Zadanie nr 15 poz 1 – 4

Zadanie nr 17 poz 1

Zamawiający wymaga aby oferowane w/w pozycje spełniały wymagania wspomnianej w opisie normy EN 13795. P prosimy o uściślenie które pozycje powinny spełniać wymagania wysokie normy , a które wystarczy aby spełniały wymagania standardowe w/w normy ?

Odpowiedź

Zamawiający dla wyrobów które zawiera:

- Zadanie nr 5 poz 1-4
- Zadanie nr 7 poz 1- 3
- Zadanie nr 8 poz 1- 3
- Zadanie nr 15 poz 1 – 4

żąda spełniania wymagań wysokich normy EN 13795

natomiast dla wyrobów które zawiera:

- Zadanie nr 10 poz 1
- Zadanie nr 14 poz 1- 3
- Zadanie nr 17 poz 1

żąda spełniania wymagań standardowych normy 13795

Pytanie 131

Zadanie nr 19 poz 1

Zwracamy się prośba o dopuszczenie ubrań o gramaturze 35g/m² – pozostałe parametry bez zmian.


Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 132

Zadanie nr 21 poz 1

Zwracamy się prośba o dopuszczenie zestawu o nast. składzie – pozostałe parametry bez zmian:

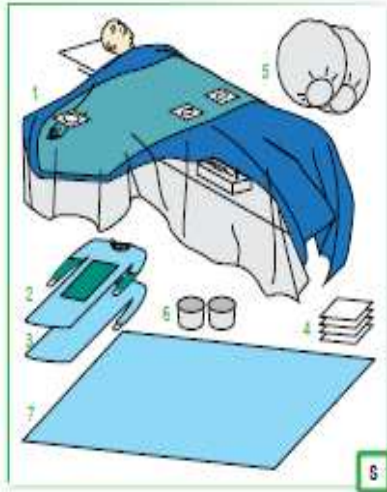

ZESTAW DO ANGIOGRAFII VIII

380295 2

ZESTAW MULTIPLEX ANGIO 226/305

rozmiar szt.

1.	serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 235x300 cm z przezroczystą foliową wstawką o wymiarach 70x300 cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa zaślepienie otwory w okolicach ft. ułowych (Ø 9) otoczone taśmą samoprzylepną, oraz dwa zaślepienie otwory eliptyczne w okolicach ft. promieniowych (Ø9) otoczone taśmą samoprzylepną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 100x150 cm	735x300	1
2.	fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach	1	1
3.	fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS	1	1
4.	ręczniki chłonne	30x40	4
5.	osłona na ekran radiologiczny	Ø 80	2
6.	pojemniki plastikowe	500 ml	2
7.	serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Lub zestaw jak poniżej pozostałe parametry bez zmian:

**Zestaw operacyjny do angiografii
MULTIPLEX ANGIO
ref.380507**

ZAU180N302GW

Ver. 02/10
02-10-2010

Obłożenie zabiegowe 180x300 cm wyposażone w warstwę chłonną z dwoma otworami 15x12 cm wypełnionymi folią chirurgiczną

Osłona na aparatę (Ø 80 cm- 1 szt.)

Osłona na ekran (Ø 50 cm- 1 szt.)

Obłożenia z taśmą (75x75 cm- 4 szt.)

Obłożenie z taśmą (50x60 cm- 1 szt.)

Ściereczki do rąk (30x40 cm- 2 szt.)

Fartuchy chirurgiczne bez wstawek (rozmiar XL- 2 szt.)

Pojemniki PP (kubeczki:150 ml - 4 szt.)

U W A G A !

Komponenty (pojemniki PP) są przeznaczone tylko do gromadzenia nieinwazyjnych cieczy lub ciał stałych

📖 Instrukcja aplikacji folii chirurgicznej na odwrócenie strony

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 133

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz. 2 serwety zabiegowej o wymiarach 200x265cm zintegrowanej z nogawicami, z otworem lepym w części kroczonej 9x12cm. pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 134

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8, pozycji 1 serwety zabiegowej o wymiarach 200x300cm wykonanej z włókniny polipropylenowo-poliestrowej o gramaturze powyżej 60g/m². Serweta posiada w części centralnej otwór wypełniony folią chirurgiczną i worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów.

Oraz serwety dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej o wymiarach 70x80cm. pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 135

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 w pozycji 3 obłożenie do znieczuleń przewodowych o wymiarze 100x75cm z otworem 6x 15cm z czterema końcami lepymi umożliwiającymi aplikację serwety. Gramatura obłożenia 54g/m².

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 136

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 10 w pozycji 1 serwety okulistycznej o wymiarach 100x150cm z otworem 6x8cm, samoprzylepnym. Serweta wykonana z laminatu o gramaturze 54g/m²

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 137

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 21 pozycji 1 zestawu do zabiegów angiograficznych o niezmiennym składzie gdzie serweta zabiegowa jest wykonana z włókniny typu SMS o wymiarach 300x200cm z dodatkową warstwą chłonną wokół otworów.

Odporność na przenikanie cieczy powyżej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro powyżej 180kPa, gramatura w części krytycznej pow.150 g/m² w części niekrytycznej 51g.m². Serweta wyposażona w dwa otwory 9x12cm zintegrowane z folią chirurgiczną oraz 2 x ściereczki chłonne o wymiarach 30x35cm wykonane z chłonnej włókniny celulozowej. Pozostały skład i parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź


Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 138

Zwracamy się prośba o dopuszczenie nast. pozycji o w nast. parametrach :

Zadanie nr 6 poz 1 :

Prosimy o możliwość zaproponowania nast. zestawu :

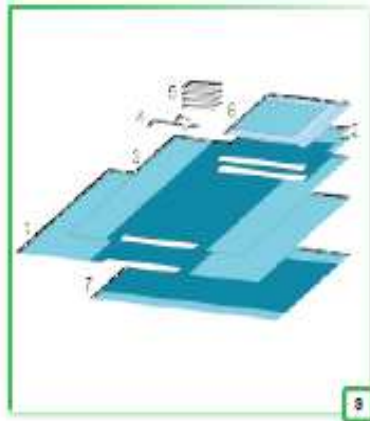

ZESTAW UNIWERSALNY LIGHT I		790500	14	BARRIER	
ZESTAW UNIWERSALNY LIGHT				rozmiar	szt.
1.	serweta górna z taśmą samoprzylepną	240x150			1
2.	serweta boczna z taśmą samoprzylepną	30x75			2
3.	serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175			1
4.	taśma samoprzylepna	9x40			1
5.	ręczniki chłonne	18x25			4
6.	osłona na stolik MAYO	70x145			1
7.	serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	140x180			1

Osobno pakowana kieszeń z taśmą lepną o wymiarach 40x35 cm na ssak i koagulację– pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139

Zadanie nr 16 poz. nr 4

Czy nie nastąpiła pomyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia w rozmiarze kieszeni? Czy Zamawiający miał na myśli kieszeń o rozmiarze min. 2x15x28?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską w formularzu cen jednostkowych wskazaną powyżej. Zamawiający wyjaśnia iż ofertę należy złożyć na przedmiot Zamówienia opisany w formularzu cen jednostkowych z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE