

Szczecin, dn. 24.01.2014 r.

znak sprawy: ZP/220/08/14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego anestetycznego, wkluc do hemodializ oraz zgłębników.

Wyjaśnienie nr 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści przedłużacz o długości 15 cm, w opakowaniu zbiorczym po 250 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**Pytanie nr 2:**

Zadanie nr 3.poz.2

Czy zamawiający dopuści przewodnicę osobno dla rurki o średnicy od 4,5-6 mm i od 7-10 mm o długości 33 cm bez zagięcia, 38 cm z zagięciem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**Pytanie nr 3:**

Zadanie nr 2

Czy w zadaniu nr 2, zamawiający zezwoli na zaferowanie cewników zgodnych z SIWZ bez strzykawki w zestawie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję.**Pytanie nr 4:**

Zadanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zaferowanie w zestawie cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu miękkiego w temperaturze ciała?, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**Pytanie nr 5:**

Zadanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 2 sterylnych, apyrogennych, poliuretanowych, dwuświatłowych cewników o rozmiarze 12 Fr i długości 15,17 oraz 20 cm, przewodnik 0,89 mmx 50 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Dopuszczenie takich cewników umożliwia złożenie konkurencyjnej oferty a złożone w postępowaniu próbki ocenie spełnienia oczekiwań Zamawiającego zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**Pytanie nr 6:**

Zadanie nr 2

Prosimy o zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 próbek w rozmiarze 15-16 cm oraz 20 cm, tak jak to zostało opisane w formularzu cenowym zamiast 15 cm i 20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dot. Zadania nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 włączyć do dializ apirogennych i atrombogenicznych wykonanych z poliuretanu, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 6,35 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dot. Zadania nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 włączyć do dializ wykonanych z poliuretanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób:
„Ilości wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu(ach) cen jednostkowych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 wzoru umowy w następujący sposób:
„Sprzedający zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej niż 2/3 okresu przydatności zagwarantowanego przez producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 wzoru umowy w następujący sposób:
„Wykonawca zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący sposób: *„w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki , licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób: „w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedającego – w wysokości 10% brutto niezrealizowanej części umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 3 na zgodny z zapisami §2 ust. 3.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę. **§10 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:**

3. W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust 1 umowy, wynoszącego co najmniej 7 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów i obciążyć Sprzedawcę kwotą odpowiadającą wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar mownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu.

Pytanie nr 15:

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY:

Prosimy o modyfikację §13 ust. 2 następujący zapis: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

a) *zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, na asortyment inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego (z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu) z uwagi na:*

- *zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;*
- *wycofanie z obrotu lub;*
- *wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub;*
- *wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub;*
- *brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;*
- *wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy, przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu lub;*
- *inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert;*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

b) *zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

c) *zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

d) *rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron – w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty (np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu)*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

e) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit. b)-d), o zakres tych zmian.”

Odpowiedź: . Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostawienie sobie możliwości dokonywania zmian w określonym powyżej zakresie w przypadkach nie dających się przewidzieć pozwala stronom na etapie realizacji umowy na elastyczne reagowanie i korygowanie zobowiązania w stopniu, w jakim jest to nieuniknione bez pokrzywdzenia Zamawiającego. Aktualne brzmienie umowy może doprowadzić do braku możliwości rozwiązania pewnych sytuacji na gruncie prawnym, w związku z zakazem istotnych zmian postanowień zawartej umowy wyrażonym w art. 144 ustawy PZP, co może skutkować szkodą każdej ze stron (np. w przypadku braku fizycznej możliwości dostarczenia danego urządzenia z przyczyn niezależnych od stron (wycofanie z produkcji), bez możliwości zastąpienia go innym, aktualne brzmienie umowy doprowadzić może do sytuacji, że umowa będzie niezrealizowana, Zamawiający nie nabędzie żadnego, nawet lepszego urządzenia, a Wykonawca będzie niesłusznie obciążony karami za zwłokę).

Konieczność przewidzenia dopuszczalności ww. zmian jest szczególnie istotna w postępowaniach o bardzo szerokim zróżnicowaniu sprzętu i niezwykle obszernym pod względem ilości dostarczanego asortymentu (tzw. kompleksowych). Nasze bogate doświadczenie w wykonywaniu tego typu dostaw uczy jednoznacznie, że nieprzewidziane sytuacje w przypadku tak dużej liczby urządzeń statystycznie muszą mieć miejsce.

Należy również zaznaczyć, że wprowadzenie powyższego zapisu nie narzuca na Zamawiającego konieczności wyrażenia odgórnego zgody na każdą taką zmianę, a daje mu jedynie możliwość wyboru. Zawsze bowiem do zgody na zmianę umowy wymagana jest zgoda obu stron. Prosimy więc o wprowadzenie ww. zapisu mając powyższe na uwadze.

Pytanie nr 16:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie 1 Pakiet 1 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 150ml, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 58ml, opór 2,9cm, waga 31g, skuteczność nawilżania 32mg H₂O/L, pakowany-folia, Opakowanie pojedyncze oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, producent, data ważności. Opakowane jednostkowe kartonowe oznakowane tak jak jednostkowe plus liczba sztuk w opakowaniu. W opakowaniu kartonowym 50 filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie 2 Pakiet 1 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie czysty dla dorosłych od obj. oddech 200ml z wymiennikiem, skuteczność filtracji >99,99%, skuteczność nawilżania >30,6mg H₂O/L, przestrzeń martwa 60ml, opór 2,6cm, waga 30g, pakowany-folia, Opakowanie pojedyncze oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, producent, data ważności. Opakowane jednostkowe kartonowe oznakowane tak jak jednostkowe plus liczba sztuk w opakowaniu. W opakowaniu kartonowym 150 filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie 3 Pakiet 1 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie

czysty dla dorosłych od 200ml obj. oddech., bez wymiennika, skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 60ml, opór 2,2cm, waga 28g, Opakowanie pojedyncze foliowe, oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, producent, data ważności. Opakowane jednostkowe kartonowe oznakowane tak jak jednostkowe plus liczba sztuk w opakowaniu. W opakowaniu kartonowym 150 filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie 4 Pakiet 1 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie czysty o zmniejszonej przestrzeni martwej dla dorosłych i starszych dzieci od objętości oddechowej 100ml, skuteczność filtracji >99,9%, przestrzeń martwa 34ml, opór 2,1cm, waga 19g, Opakowanie pojedyncze foliowe, oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, producent, data ważności. Opakowane jednostkowe kartonowe oznakowane tak jak jednostkowe plus liczba sztuk w opakowaniu. W opakowaniu kartonowym 100 filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie 5 Pakiet 1 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy noworodkowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 11ml, opór 1,1cm H₂O przy 11L/min., waga 12g, skuteczność nawilżania 27mg H₂O/L przy VT 25ml, z portem kapno bez luer-lock, ale z zatyczką na lince, która zwiększa bezpieczeństwo stosowania filtra, opakowanie-folia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie 6 Pakiet 1 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie: Sterylny. Dla pacjentów na własnym oddechu. Opakowanie jednostkowe folia-papier. Opakowanie oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, producent, data ważności. Opakowane zewnętrzne kartonowe oznakowane tak jak jednostkowe plus liczba sztuk w opakowaniu. W opakowaniu zewnętrznym 40 filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie 7 Pakiet 1 Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie: Wymiennik ciepła i wilgoci na rurkę tracheostomijną i intubacyjną, posiadający standardowe, zwężane złącze żeńskie o średnicy 15 mm, dwa piankowe elementy HME pewnie zamocowane, zapewniając integralność produktu, nawet gdy pacjent zakaszele, przezroczysta obudowa, port do odsysania zakryty klapką, zwrot wilgoci 26 mg H₂O/L, przestrzeń martwa 19ml, waga 8gr, minimalna objętość oddechowa 50ml, złącze tlenowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie 8 Pakiet 1 Pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie masek twarzowych Jednokrotnego użytku. Pojedynczo pakowanych mikrobiologicznie czystych nie wymagających dopełniania mankietu z termoplastycznym mankietem anatomicznie wyprofilowanym ,w wersji eco ,bez ftalanów z polipropylenu, z kodem kolorystycznym W rozmiarach 3, 4, 5. Na opakowaniu nazwa, rozmiar, nr

katalogowy, nr serii, data ważności. Wymagana karta katalogowa produktu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie 9 Pakiet 1

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z rezerwuarem i drenem 210 cm dla dorosłych, nie zawierających lateksu i ftalanów

Konstrukcja worka zapewniająca właściwy przepływ tlenu oraz redukująca niebezpieczeństwo zagięcia worka. Pakowana pojedynczo. Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. Opakowanie zbiorcze opisane jak pojedyncze + liczba sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję.

Pytanie nr 25:

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie 10 Pakiet 1 Pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie zestawu wyposażonego w skalowany nebulizator o pojemności 10 ml spełniający pozostałe wymagane parametry techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26:

W związku z zapisami SIWZ i z brakiem zapisu w SIWZ o możliwości zaoferowania produktów równoważnych wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie poniższego

Zadanie nr 1 Poz 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o lepszym poziomie nawilżania 29,2 mg H₂O / l, tak jak obecnie stosowane w Państwa Placówce.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 1 Poz 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej mikrobiologicznie czystej tak jak obecnie używane?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę **na zaoferowanie maski anestetycznej mikrobiologicznie czystej.**

Zadanie nr 1 Poz 7

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do inhalacji z drenem o długości 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2/ Czy w celu optymalnej depozycji nebulizowanych cząsteczek w dolnych drogach oddechowych pacjenta średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. parametr a nie wymaga.

Pytanie nr 27:

Zadanie 3 Poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej przestrzeni martwej rozciągalnej w zakresie 7-15 cm co spełni Państwa oczekiwania odnośnie długości 10 i 15 cm oraz z logistycznego i klinicznego punktu widzenia będzie wygodniejszym rozwiązaniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylną przestrzeń martwą rozciągalną w zakresie 7cm-15 cm.

Pytanie nr 28:

Pytania do SIWZ

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedstawienia katalogów zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności z wymogami SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w trakcie badania ofert indywidualnie będzie wyjaśniał oferty, o ile zajdzie taka konieczność.

Pytanie nr 29:

Pytania do umowy

W związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź: Zamawiający dopisuje do **§ 6 ust. 4 o następującej treści:**

4. Realizacja każdego z zadań wymienionych w ust. 1 ma charakter samodzielnego, odrębnego zobowiązania stron.

Pytanie nr 30:

Pytania do umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §10 pkt.1 ust. b „w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 10% wartości brutto umowy (wartości zadania) określonej w § 6 umowy” na zapis „w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 10% wartości brutto umowy (niezrealizowanej wartości zadania) określonej w § 6 umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31:

Dotyczy zadania 1. Filtry, maski

Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Filtr sterylny antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci i portem do kapnografii, z nawilżaczem. Możliwość stosowania z respiratorem.

Przeźrzeń martwa maksymalnie 53 ml/l H₂O.

O wyższej skuteczności wirusowej tj. 99,999% oraz skuteczności bakteryjnej 99,9999%.

Skuteczność nawilżania 30,6 mg/l H₂O.

Większa objętość oddechowa tj. od 150 do 1500 ml ?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32:

Dotyczy zadania 1. Filtry, maski

Zadanie 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Filtr sterylny antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii

Możliwość stosowania z respiratorem. Z portem do kapnografii.

O większej objętości oddechowej (wdechowej) tj. od 150 do 1500 ml.

O wyższej skuteczności wirusowej tj. 99,999% oraz skuteczności bakteryjnej 99,9999%.

oraz czy Zamawiający odstąpi od wymogu :skuteczność nawilżania minimum 29 mg/l H₂O, gdyż chyba zaistniała pomyłka. Jest to filtr bez wymiennika ciepła i wilgoci, więc nie będzie miał takiej samej skuteczności jak Filtr w poz. 1 z wymiennikiem ciepła i wilgoci? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33:

Dotyczy zadania 1. Filtry, maski

Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Filtr sterylny elektrostatyczny pediatryczny, z piankowym wymiennika ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31mgH₂O, przestrzeń martwa 22ml,

O większej objętości oddechowej (wdechowej) tj. od 70 do 600 ml.

O wyższej skuteczności wirusowej tj. 99,999% oraz skuteczności bakteryjnej 99,9999%, waga 16,5g. Ze złączem kolankowym, z portem kapno, zakręcanym korkiem luer-lock?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34:

Dotyczy zadania 1. Filtry, maski

Zadanie 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne czyste mikrobiologiczne, bez lateksu, bez PCV, wolne od ftalanów? Pozostałe parametry bez zmian.

Posiadamy w swojej ofercie maski aż 4 producentów, ale żadne z nich nie są sterylne i takie są stosowane od lat w szpitalach. Dlatego prosimy o odstąpienie wymogu sterylności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję.

Pytanie nr 35:

Dotyczy zadania 1. Filtry, maski

Zadanie 1, poz. 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z rezerwuarem i drenem długości 200cm, opakowanie zbiorcze 100 szt. pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36:

Dotyczy zadania 1. Filtry, maski

Zadanie 1, poz. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do inhalacji, nebulizator o pojemności 8 ml, pozycja pionowa, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję.

Pytanie nr 37:

Zadanie nr 2 – „Wkłucia do hemodializ”

Czy Zamawiający dopuści wkłucie do hemodializ sterylne, dwuświatłowe, polyueratanowe, dializacyjny, rozmiar 11Fr, o długości 20 cm, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 1x przewodnik, 1x rozszerzacz, 1x przewodnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38:

Zadanie nr 2 – „Wkłucia do hemodializ”

Czy Zamawiający dopuści wkłucie do hemodializy sterylne, dwuświatłowe, polyueratanowe, dializacyjny, rozmiar 11Fr, o długości 15 cm, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 1x przewodnik, 1x rozszerzacz, 1x przewodnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39:

Zadanie nr 2 – „Wkłucia do hemodializ”

Czy Zamawiający dopuści wkłucie do hemodializ rozmiar 11,5Fr, o długości 16 cm?

Odpowiedź: Wskazane parametry rozmiar 11,5 Fr oraz długość 16 cm – odpowiada wymaganiom określonym w Formularzu cen jednostkowych. Oczywiście przy założeniu, że

pozostałe parametry również zostaną zachowane.

Pytanie nr 40:

Paragraf 1 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Ilości wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu(ach) cen jednostkowych”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41:

Paragraf 2 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedawca zobowiązuje się, na każde żądanie Kupującego, przedłożyć dokument potwierdzający dopuszczenie danego wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP w ciągu 3 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

Paragraf 3

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu o następującej treści:
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43:

Paragraf 3 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust 1 umowy, wynoszącego co najmniej 7 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów i obciążyć Sprzedawcę różnicą w kosztach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44:

Paragraf 5 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego zapisy z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

Dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Filtr sterylny antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci i portem do kapnografii: Skuteczność filtrowania względem bakterii 99,9998%, względem wirusów 99,999%; Przestrzeń martwa - 51 ml; Objętość oddechowa – 150 - 1200 ml; Średnica filtra – od 5 cm do 7 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46:

Dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w dopuści Filtr sterylny antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii: Skuteczność filtrowania względem bakterii 99,9999%, względem wirusów 99,999%; Objętość oddechowa –150 – 1200 ml; Skuteczność nawilżania czy nie nastąpiła pomyłka, to ma być filtry bez wymiennika, Średnica filtra – od 5 cm do 7 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47:

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w dopuści Filtr sterylny elektrostatyczny pediatryczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,99%. Nawilżanie na poziomie 31 mgH₂O/l przy V_t 250 ml, przestrzeń martwa 29 ml, objętość oddechowa 75-300 ml, waga 21 g; Ze złączem kolankowym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Dotyczy zadania nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający w dopuści Maskę anestetyczną, której zawór można odbarczyć za pomocą strzykawki lub manometru, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję.

Pytanie nr 49

Dotyczy zadania nr 1 poz. 6


Czy Zamawiający w dopuści Maskę tlenową z rezerwuarem: Dren 213 cm, klasyczny nieruchomy łącznik, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję.

Pytanie nr 50

Dotyczy zadania nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający w dopuści Zestaw do inhalacji z dren tlenowy 2 m; wejścia 22F - 22M/15F; pojemność nebulizatora 8 ml; nebulizator pracujący w pozycji max 45 stopni, obrazek poniżej ?

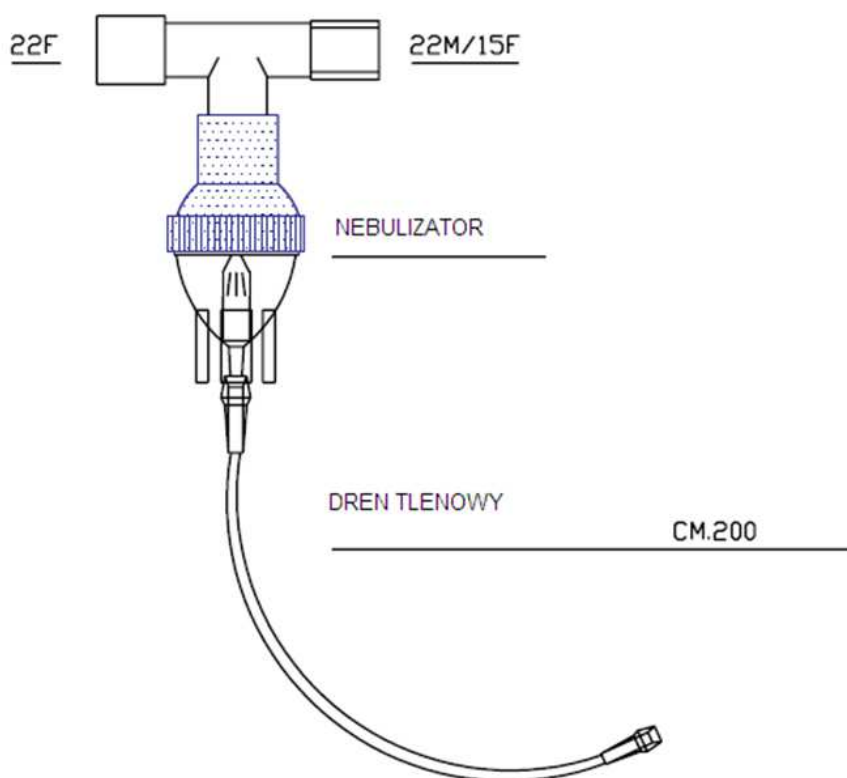

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie **w zadaniu nr 7 poz.1** dwuświatłowych wkłuc dializacyjnych, sterylnych, apyrogennych, wykonanych z biostabilnego poliuretanu, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego. W zestawie: igła punkcyjna , prowadnik J o długości 60cm 2-światłowy cewnik, 2 rozszerzadła,2 zatyczki, skalpel skrzydełka mocujące. Opakowanie typu blister umożliwiające jałowe wyjęcie zestawu?

Odpowiedź: Pytanie zapewne dotyczy zadania nr 2 poz. 2. I w tym przypadku Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert o 1 dzień.

W związku z powyższym :

Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2014 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2014 o godz. 11:20

Miejsce otwarcia i składania ofert pozostaje bez zmian.

.....
/Dyrektor SPSK -2/