

znak sprawy: ZP/220/46/16

Szczecin, dnia 30.06.2016r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki i zabiegów radiologicznych

Wyjaśnienia 2

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje co następuje:

I. Ponownie udziela odpowiedzi na pytanie 1 i 2 zawartych w wyjaśnieniach nr 1:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 1 poz. 4 i utworzenie niezależnego zadania oraz dopuszczenie w tym miejscu filtra do żyły głównej o małym systemie wprowadzania przez śluzę w rozmiarze 6.5F.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie oraz nie dopuszcza proponowanego wyrobu.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 1 poz. 5 i utworzenie niezależnego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie.

II. Udziela wyjaśnień na poniższe pytania złożone do dnia 27.06.2016r

Pytanie 1

Pytanie nr 1. Dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 3 - punktu 1 (cewnik balonowy do PTA uwalniający lek antyproliferacyjny) oraz punktu 7 (stent do tętnic kończyny dolnej nitinolowy typu RX) w osobne zadanie?

Wszystkie pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie.

Pytanie 2

Zadanie nr 14:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny strzykawki wysokociśnieniowej o pojemności 25 ml? Pozostałe parametry techniczne urządzenia pozostają bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób.

Pytanie 3

Pytanie 1, zadanie 21

Prosimy o dopuszczenie rozbudowanego ZESTAWU DRENAŻOWEGO do drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach:

- obrotowe skale ciśnienia umożliwiające drenaż komorowy i lędźwiowy – w tym skala ujemna.
- W zestawie drenażu lędźwiowego dren lędźwiowy

- Możliwość zawieszenia na lince lub przymocowania do słupka infuzyjnego przy użyciu wbudowanego zacisku słupkowego
- Łatwe do rozpoznania przewody linii pacjenta w kolorze zielonym, które nie załamują się przy zginaniu drenu (brak możliwości obstrukcji drenażu przy zagięciu drenu)
- Dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej/próbkowania
- Punkty iniekcji bezigłowej SmartSitt
- Główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego przetwornika ciśnienia
- odpowietrznik hydrofobowy
- komora ściekowa 75 ml
- odłączalna, wymienna torebka drenażowa 600 ml
- Skale ciśnienia o dużych i łatwych do odczytania wartościach (mm Hg lub cm H₂O)
- **Możliwość rozbudowy o poziomice laserową Clear-Sit**
- Soczewka powiększająca na przodzie komory ściekowej umożliwiająca podgląd pulsacji płynu przy braku przepływu.
- Przystosowany do wykonywania badań MRI



Rysunek poglądowy ilustrujący skład zestawu po prawej

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie 21


Prosimy o dopuszczenie zestawu drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach:

- Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80 cm i śr. 1,5mm
- Igła Tuohy o rozmiarze 14G
- Prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem
- Występy mocujące (2 sztuki)
- Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
- Tępo zakończona igła
- Torebka drenażowa EDM 700 ml
- Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny)
- Komora kropelkowa 120 ml z podziałką

Rysunek poglądowy ilustrujący skład zestawu po prawej

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

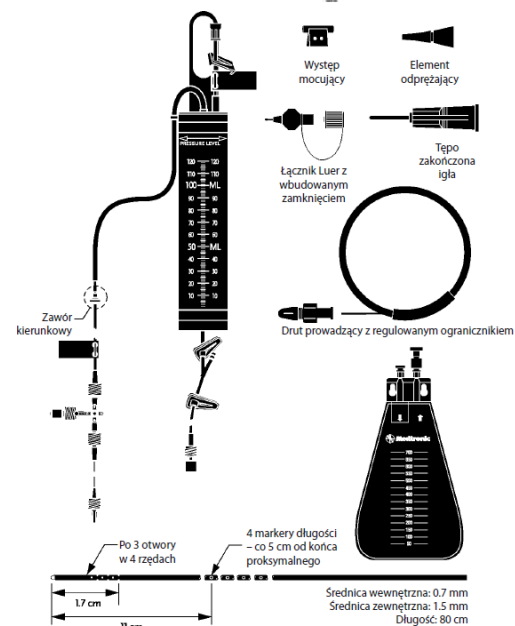


Pytanie 5

Zadanie 21

Prosimy o dopuszczenie drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach :

- Cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, 80 cm i średnicy 1,5mm
- Igła Tuohy o rozmiarze 14
- Tępo zakończona igła
- Występy mocujące (2 sztuki)
- Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
- Zespół linii pacjenta EDM z dwoma wolnymi od lateksu punktami iniekcji.
- Torebka drenażowa EDM 700 ml

Rysunek poglądowy ilustrujący skład zestawu po prawej

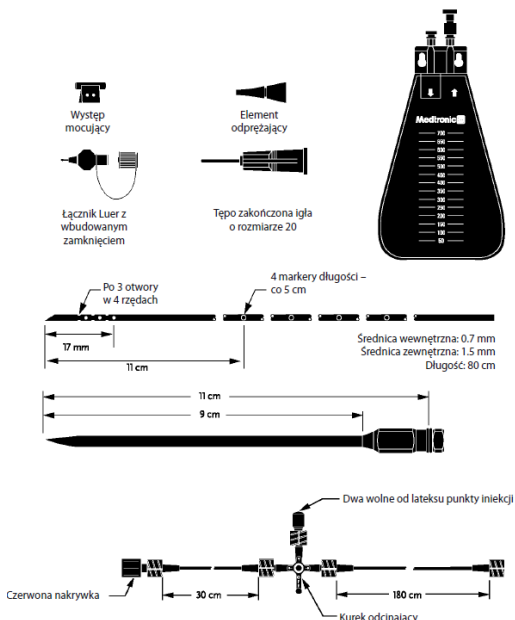

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Pytanie 4, zadanie 21

Prosimy o dopuszczenie zewnętrznego, sterylnego zestawu drenażowego, lędźwiowego z torbą o pojemności 700ml (wymagane 600ml) ze zintegrowaną komorą kroplową. Hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę. Dren lędźwiowy 80cm (wymagany min. 60) silikonowy z zatopionymi znacznikami radiologicznymi i średnicy zewnętrznej 1,5mm (światło drenu 0,7mm), igłą Touhy zestawie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 7

Pytanie 5, zadanie 21

Prosimy o dopuszczenie zewnętrznego, sterylnego zestawu drenażowego, lędźwiowego spełniającego wszystkie wymagania SIWZ z torbą o pojemności 700ml oraz drenem lędźwiowym o średnicy zewnętrznej 1,5mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie Zamawiający w załączeniu przekazuje zmieniony formularz cen jednostkowych (załącznik nr 4) wraz z wprowadzonymi zmianami ilościowymi w zakresie zadania 1, 3 oraz 21.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2